

SMARTY2.0

Manuel d'Utilisateur

Modèle : SW079



MANUEL D'UTILISATEUR

(FRANÇAIS)




1 DANS LA BOÎTE

- 1 x Montre connectée
- 1x Câble de recharge
- 1 Manuel de l'utilisateur/Guide rapide


2 VUE AVANT ET ARRIÈRE

1. Écran tactile : affiche les données de la montre. Balayez ou touchez l'écran pour sélectionner les fonctions.
2. Bouton latéral : appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pour allumer et éteindre l'appareil, et appuyez brièvement sur le bouton latéral pour revenir à l'interface de la montre ou éteindre/allumer l'écran.
3. Capteur de fréquence cardiaque
4. Capteur du taux d'oxygène dans le sang

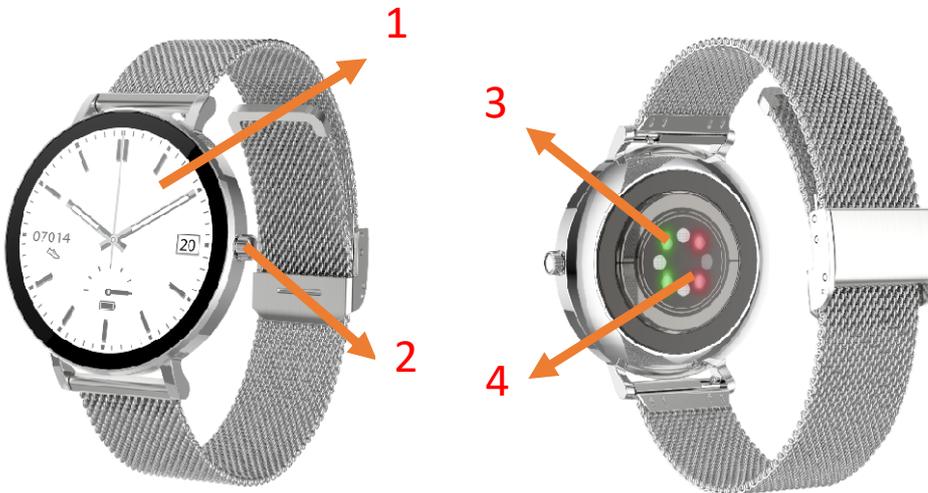

3 Charger votre montre connectée

1. Avant d'utiliser votre montre connectée pour la première fois, assurez-vous qu'elle est complètement chargée.
2. La montre connectée mettra environ 3 heures pour se charger complètement. Une fois que le chargeur est branché, la montre connectée se chargera automatiquement.
3. Placez le bracelet sur le plateau de la base de chargement et branchez l'autre extrémité du câble utilisateur dans une source d'alimentation.

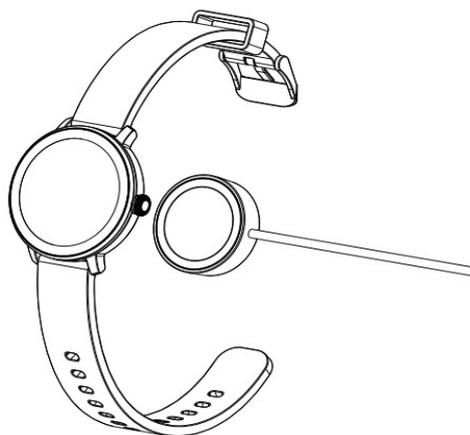

4. Installer l'application

1. Recherchez l'application Oplayer smart life dans l'App Store / Play Store pour télécharger ou scanner le code QR ci-dessous pour l'installation.



5. Connecter l'application

- a. Ouvrez l'application Oplayer smart life sur votre téléphone intelligent.
 - b. Appuyez sur la page « réglage » et sélectionnez « Connecter Appareil Intelligent ».
 - c. Sélectionnez le « SW079 » pour vous connecter. Si une fenêtre de jumelage s'affiche, appuyez sur « Jumeler » et si une fenêtre contextuelle demandant l'accès aux notifications apparaît, sélectionnez « Autoriser ».
- Après la connexion, l'application synchronisera automatiquement les données de la montre. Vous pouvez maintenant utiliser l'application.

6. Déconnecter l'application

Ouvrez l'application Oplayer smart life. Dans l'onglet « Paramètres » de l'application, sélectionnez « Oublier cet Appareil Intelligent » pour vous déconnecter.

Remarque : Si vous utilisez un iPhone et sur certains appareils Android, la montre sera toujours en mode jumelé après la déconnexion. Vous devrez entrer dans les menus des paramètres Bluetooth du téléphone pour désappairer la montre.

7. Comment l'Utiliser

1. Appuyez sur le bouton latéral pendant 3 secondes pour allumer / éteindre, balayez vers le haut / bas ou gauche / droite pour voir plus d'options.

8. Menu Principal

Raccourcis



: Cette icône est le bouton de connexion Bluetooth 3.0, cliquez sur cette icône pour connecter la montre 3.0 Bluetooth au système Bluetooth de votre téléphone. Ensuite, la montre peut recevoir des appels et jouer de la musique.


: Luminosité de l'écran, vous pouvez appuyer sur l'icône de luminosité pour régler la luminosité de l'écran.

: Mode sommeil.

: À propos, pour trouver l'adresse MAC et la version du logiciel de votre Montre Connectée.

: Réglages.

8.1 Notifications : Balayez vers le haut sur l'interface d'appel pour voir les notifications comme les appels entrants, les sms, QQ, WeChat, WhatsApp, Facebook, Twitter etc.,




8.2 Appeler : Après avoir appairé le téléphone avec le Bluetooth d'appel de la montre, appuyez sur cette icône pour passer un appel.



8.3 Historique d'appel : enregistrements des appels émis et des appels reçus.



8.4 Contacts : connectez "Oplayer smart life" et ouvrez l'application, ensuite allez sur "Synchroniser les Contacts" dans les Paramètres et ajouter les informations de contact dans vos contacts, qui seront affichées sur la montre après l'enregistrement.

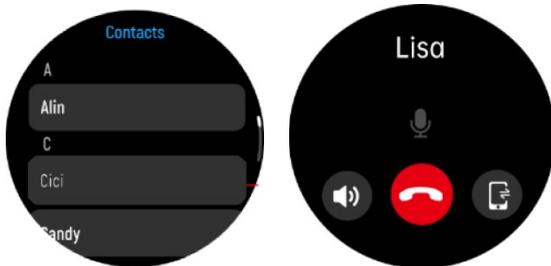

8.5 Surveillance de la Fréquence Cardiaque : Appuyez sur cette icône pour surveiller votre fréquence cardiaque actuelle. Pour sortir de la surveillance de la fréquence cardiaque, balayez de gauche à droite sur l'écran.




8.6 Moniteur d'Oxygène Sanguin : Appuyez sur cette icône pour surveiller le moniteur actuel d'Oxygène Sanguin. Pour la quitter, balayez de gauche à droite sur l'écran.



8.7 Moniteur de Stress : Cliquez sur cette icône pour surveiller votre pression actuelle, pour la quitter, balayez de gauche à droite sur l'écran.



Balayez de bas en haut, vous pouvez voir la norme de valeur.

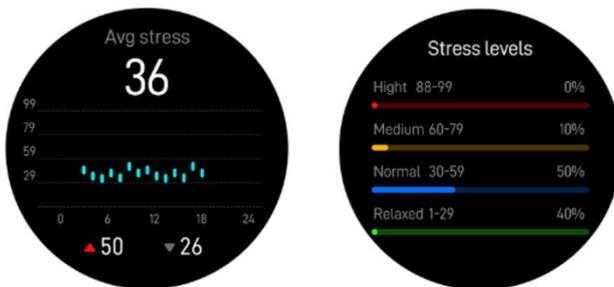

8.8 Moniteur de Sommeil : Surveillance de votre sommeil entre 21h et 9h automatiquement.



8.9 Conditions météorologiques : Afficher la météo quand la montre connectée est connectée à l'application "Oplayer Smart Life".




8.10 Obturateur : prenez des photos à distance depuis votre montre connectée.



8.11 Contrôle de la Musique : Cliquez sur l'icône musique pour entrer dans l'interface des commandes de lecture de la musique. Vous pouvez sélectionner

chanson précédente/suivante et jouer/mettre en pause la musique. Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume et vous pouvez tapoter l'icône pour configurer la sortie du son sur la montre ou sur le téléphone. Pour quitter les commandes de lecture de la musique, balayez de gauche à droite sur l'écran.

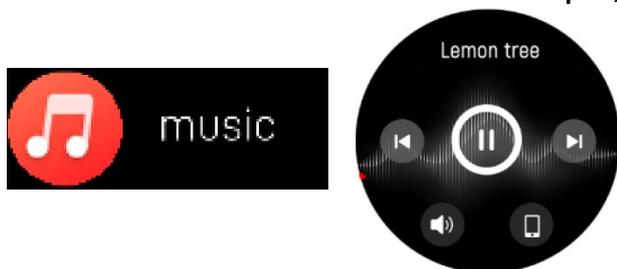

8.12 Réglages



Trouver le téléphone, trouver votre téléphone connecté.



Luminosité, vous pouvez appuyer sur l'icône de luminosité pour régler la luminosité de l'écran.



Écran activé, vous pouvez choisir une durée d'affichage différente, la plus longue étant de 200 secondes.



Cadran de la montre, balayer de droite à gauche pour sélectionner le cadran de la montre correspondant.



Style de menu.



Mode ne pas déranger.



Économie d'Énergie : Activer le mode économie d'énergie réduira la luminosité de l'écran et le BTCalling sera éteint.



Bannière de Notification.



Changement de langue



Réinitialiser les appels, cliquez sur OK pour effacer les contacts et l'historique d'appel.



Intensité des vibrations (vous pouvez régler l'intensité des vibrations sur la montre)



Fonction de calculatrice sur la montre.



Redémarrer le dispositif.



Réinitialiser le dispositif. Après avoir cliqué sur Réinitialiser, toutes les données de la montre seront effacées.



Éteindre votre montre connectée.



Système, pour trouver l'adresse MAC et la version du logiciel de votre montre connectée.



Configuration Audio.



Notifications : Plusieurs types de boutons-poussoirs de message

peuvent être contrôlés.



Surveillez la fréquence cardiaque et le niveau d'oxygène sanguin pendant 24 heures.



L'interrupteur de rappel de sédentarité. Soulevez l'interrupteur de réveil manuel. Interrupteur de rappel de boire.